


AEG 62 GWU

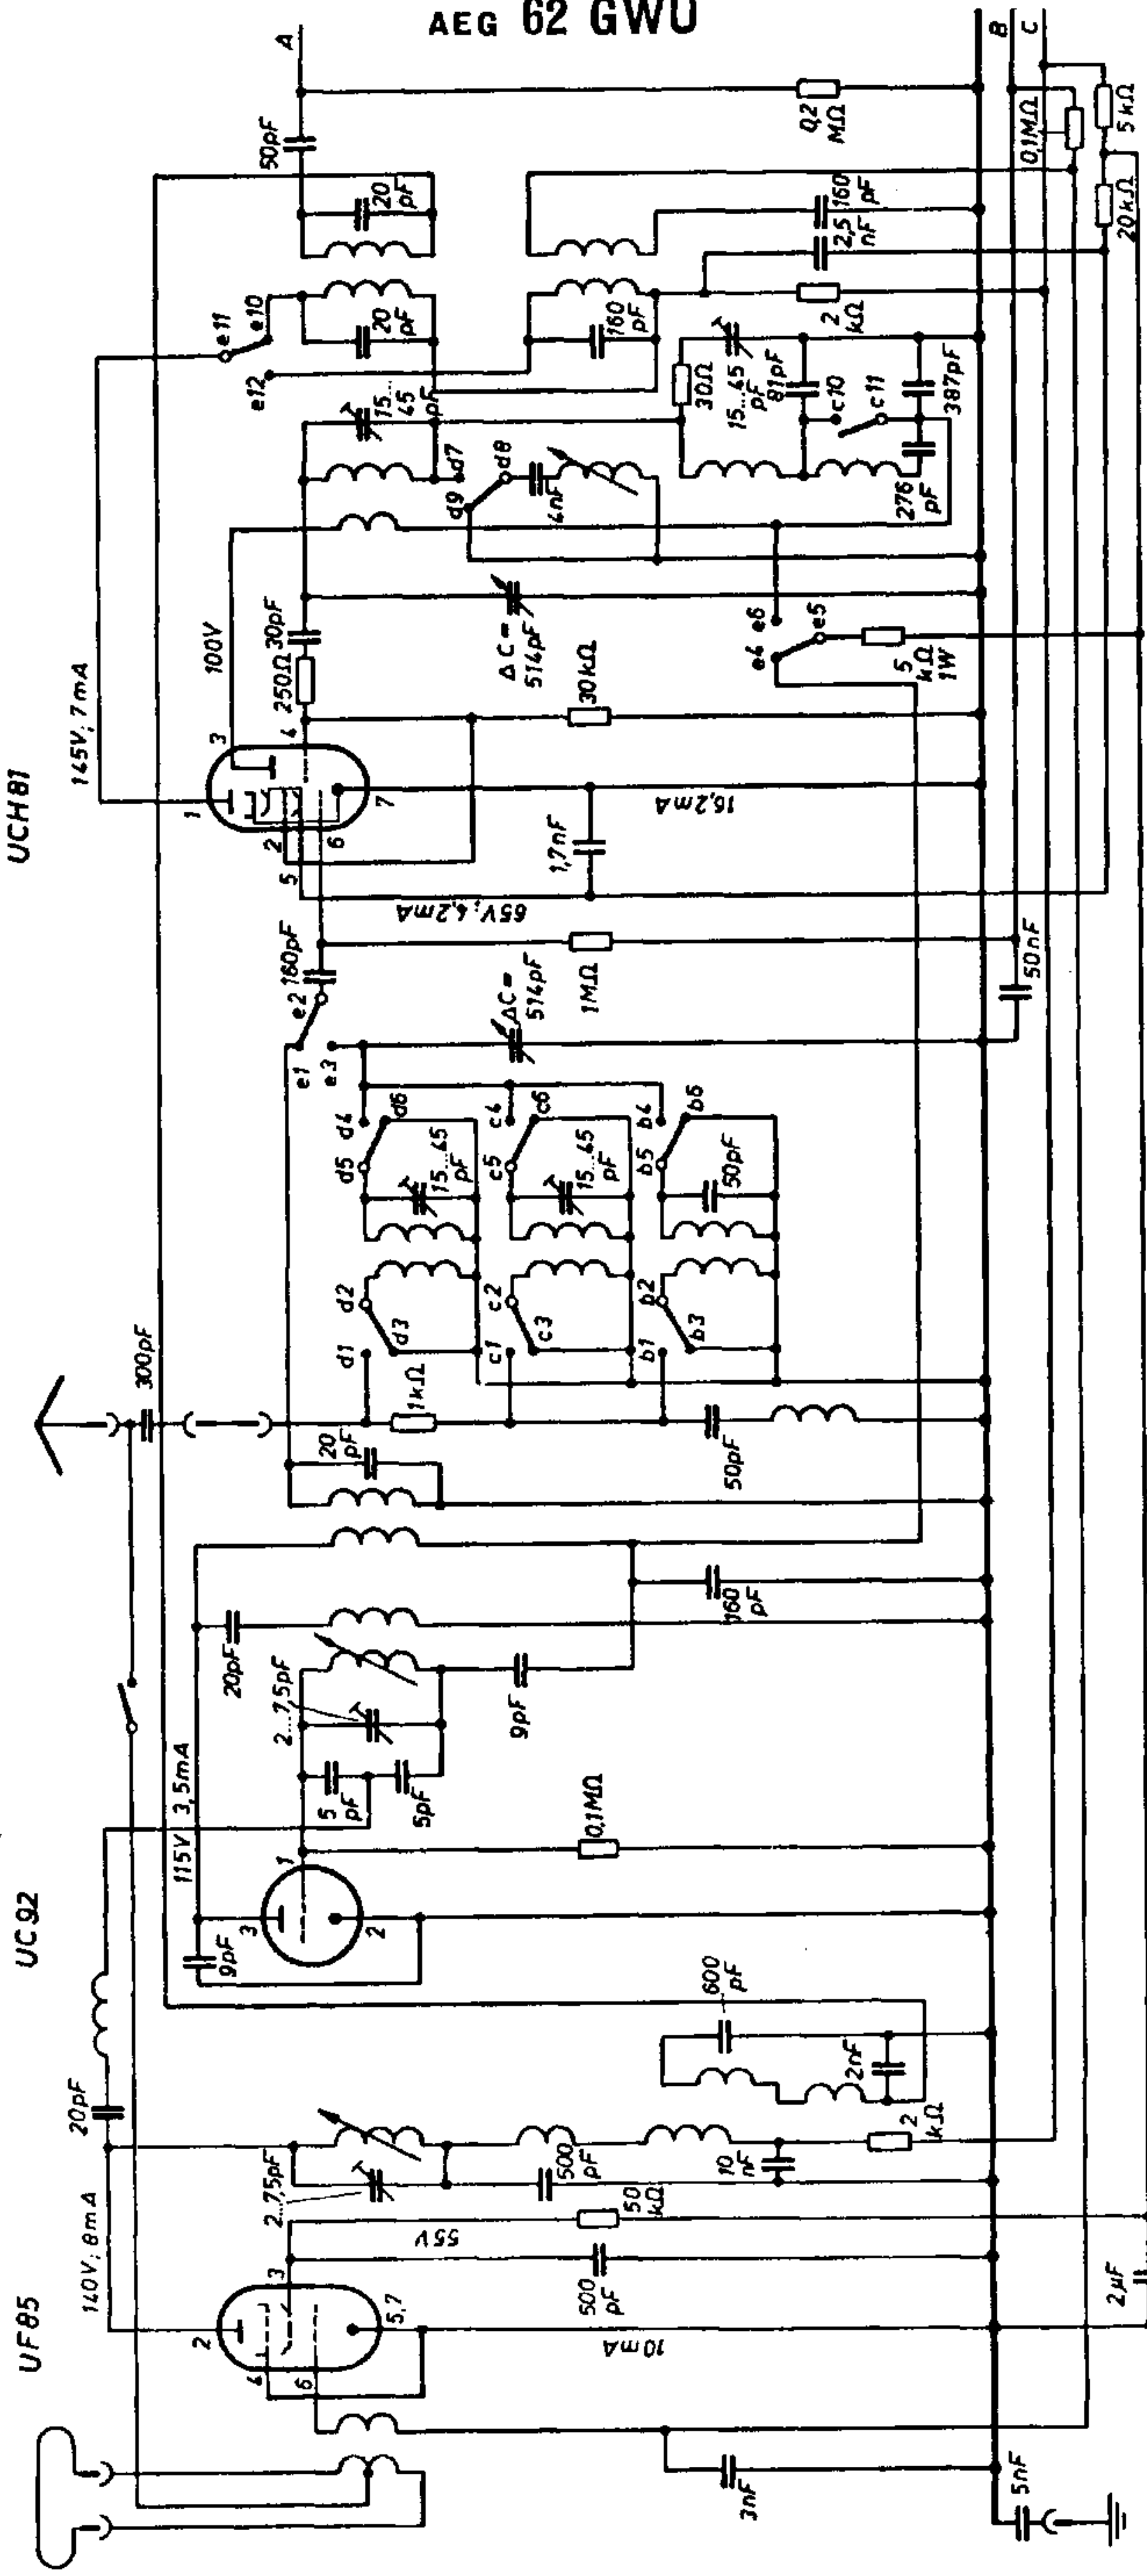


UCH81

UC92

UF85

Meßinstrument : 333Ω / V (300 bzw. 30V)

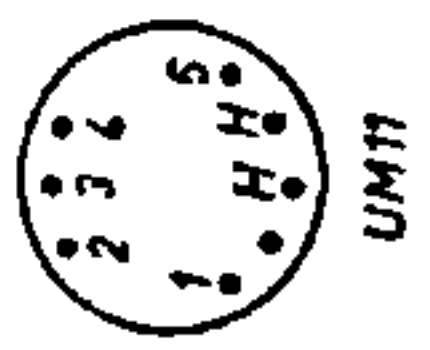

UCH81



UC92




UF85



UM11

Sockettschaltungen

Tastenstellung : UKW

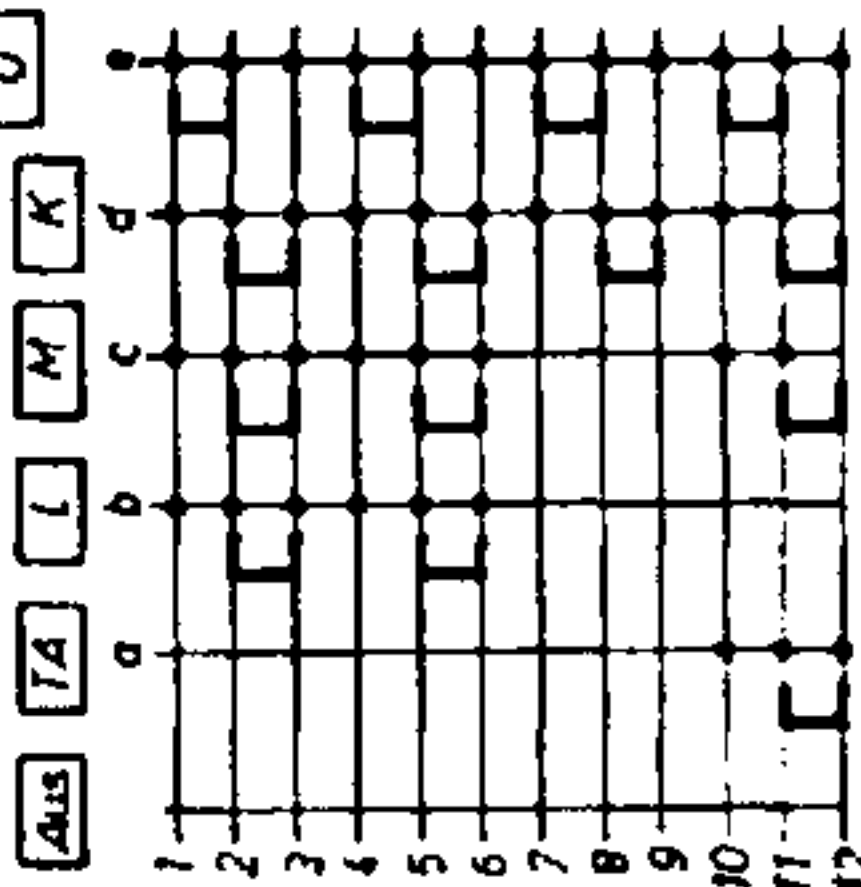

ZF = 472 kHz u. 10,7 MHz
(452 kHz bei Bandfilter C = 170pF)

