


19. Braun 300 UKW

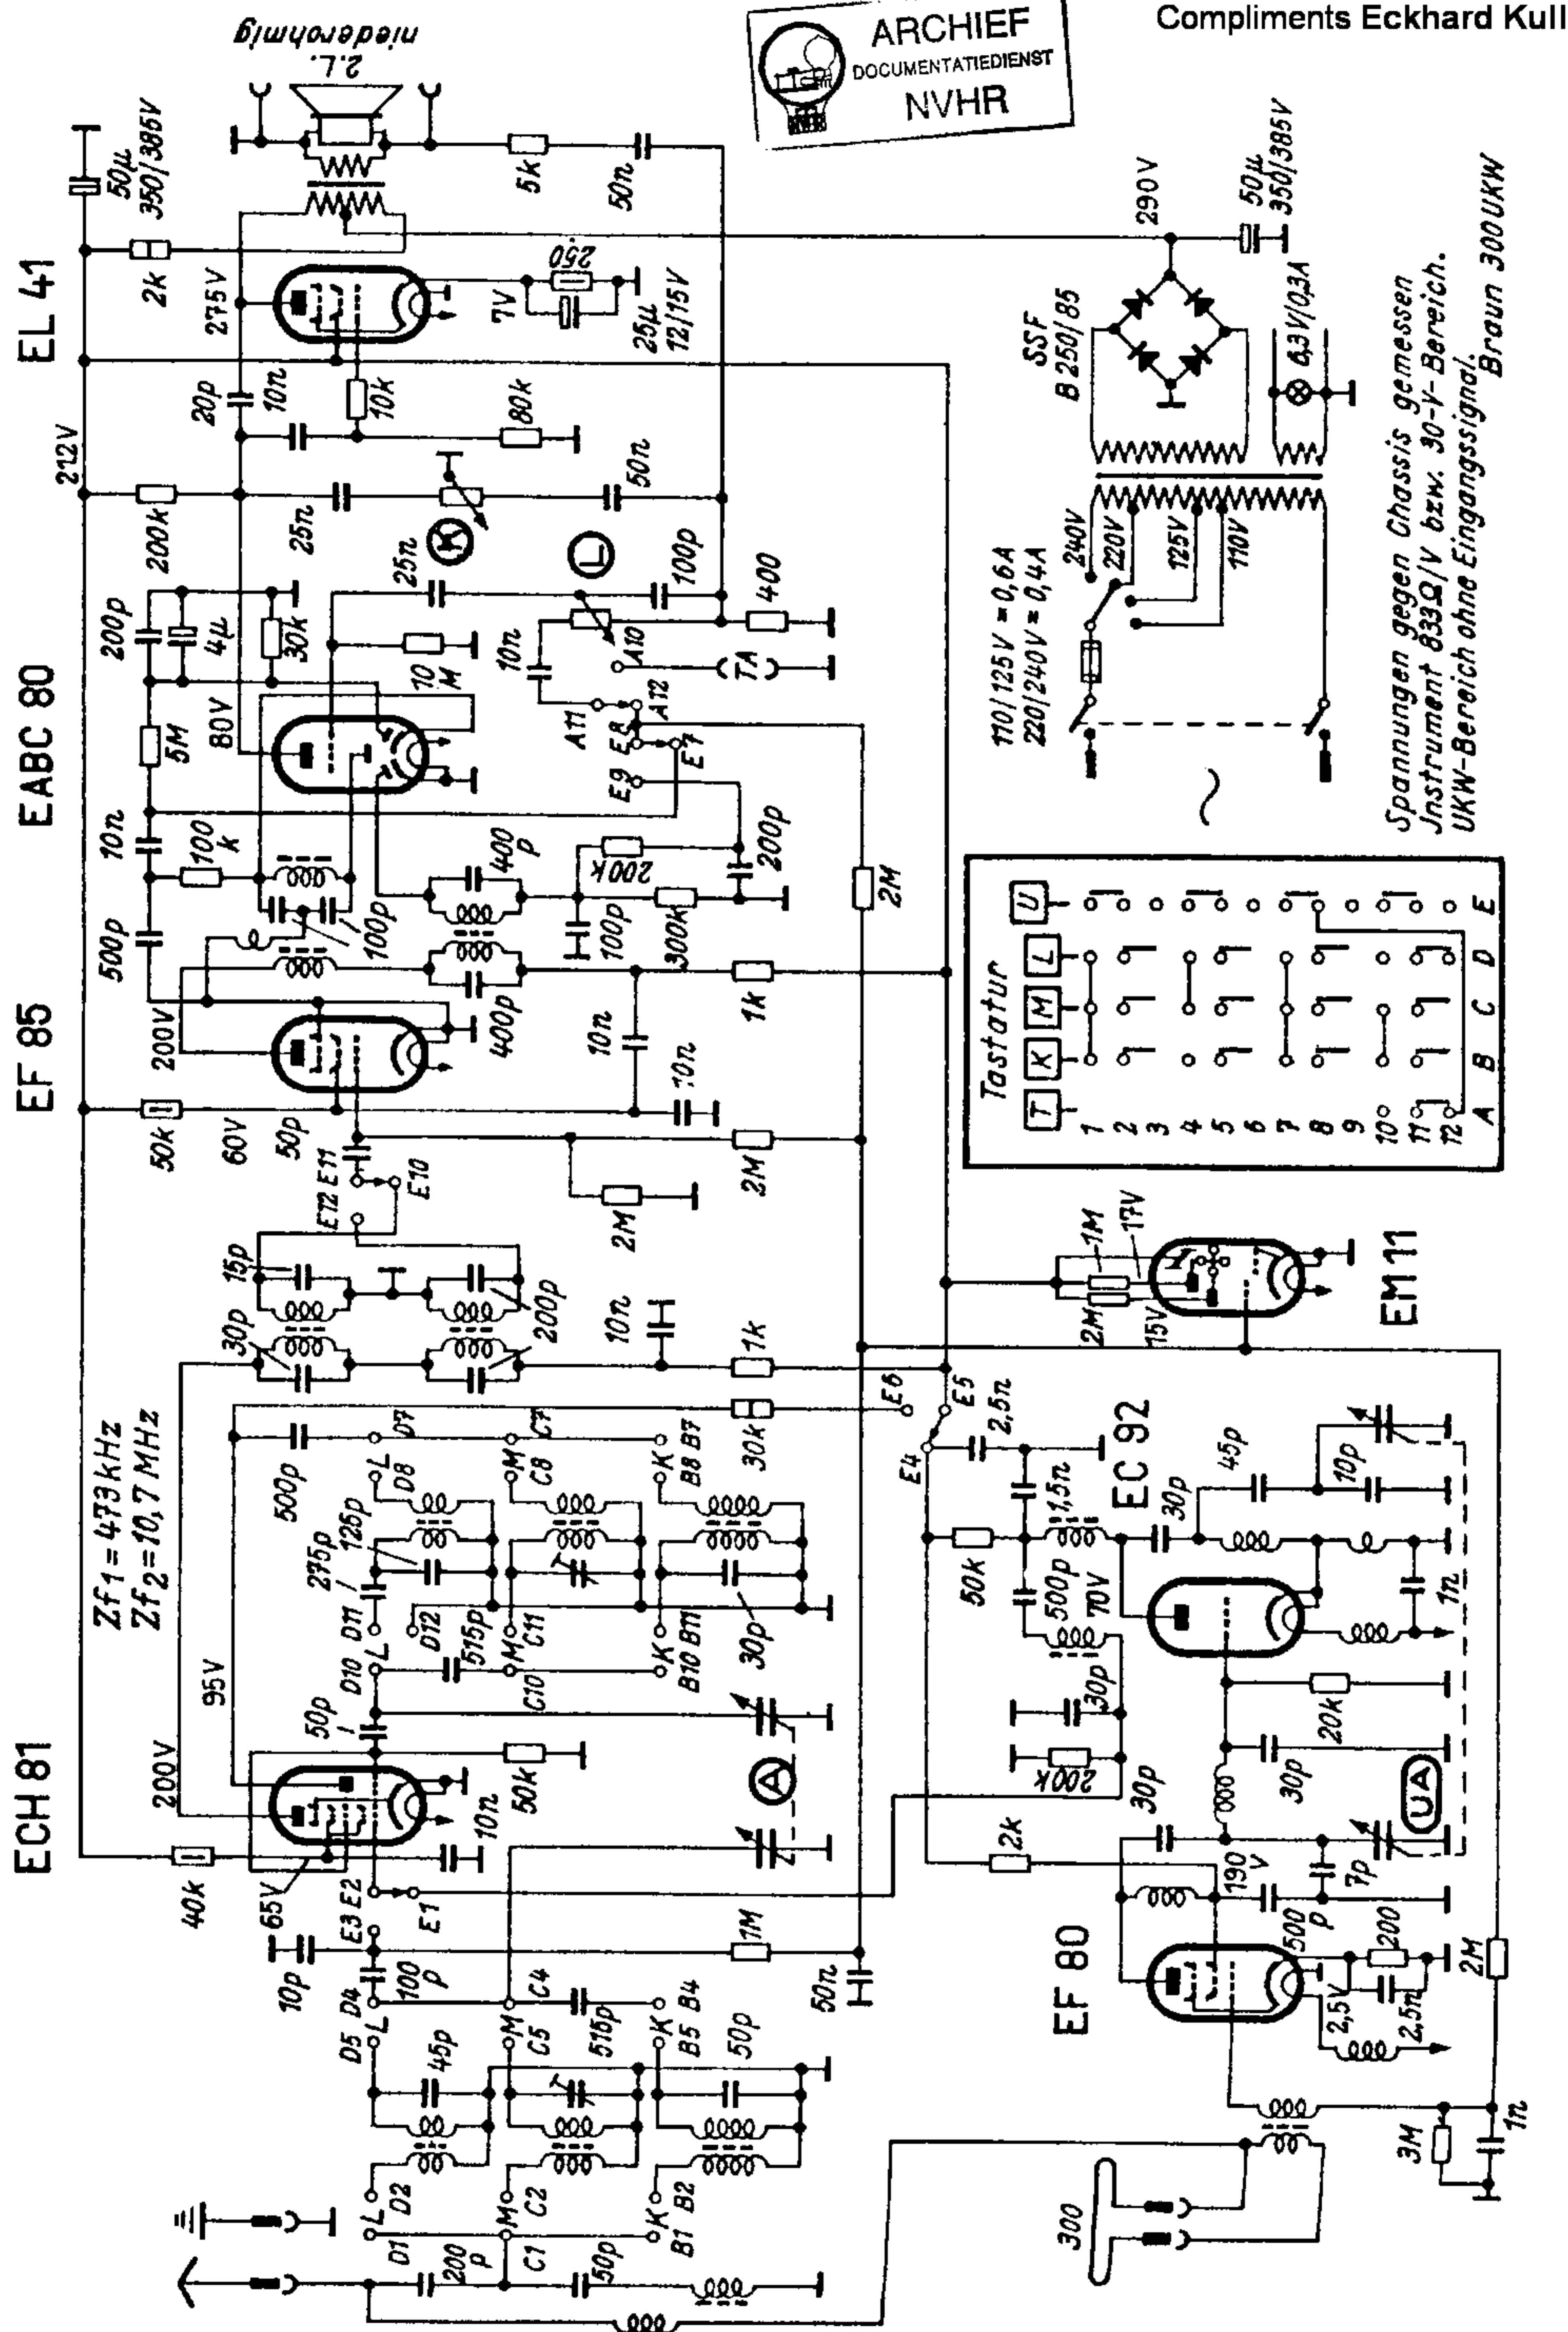

ARCHIEF  
DOCUMENTATIEDIENST  
NVHR

Compliments Eckhard Kull

Spannungen gegen Chassis gemessen  
Instrument 833Ω/V bzw. 30-V-Bereich.  
UKW-Bereich ohne Eingangssignal.  
Braun 300UKW