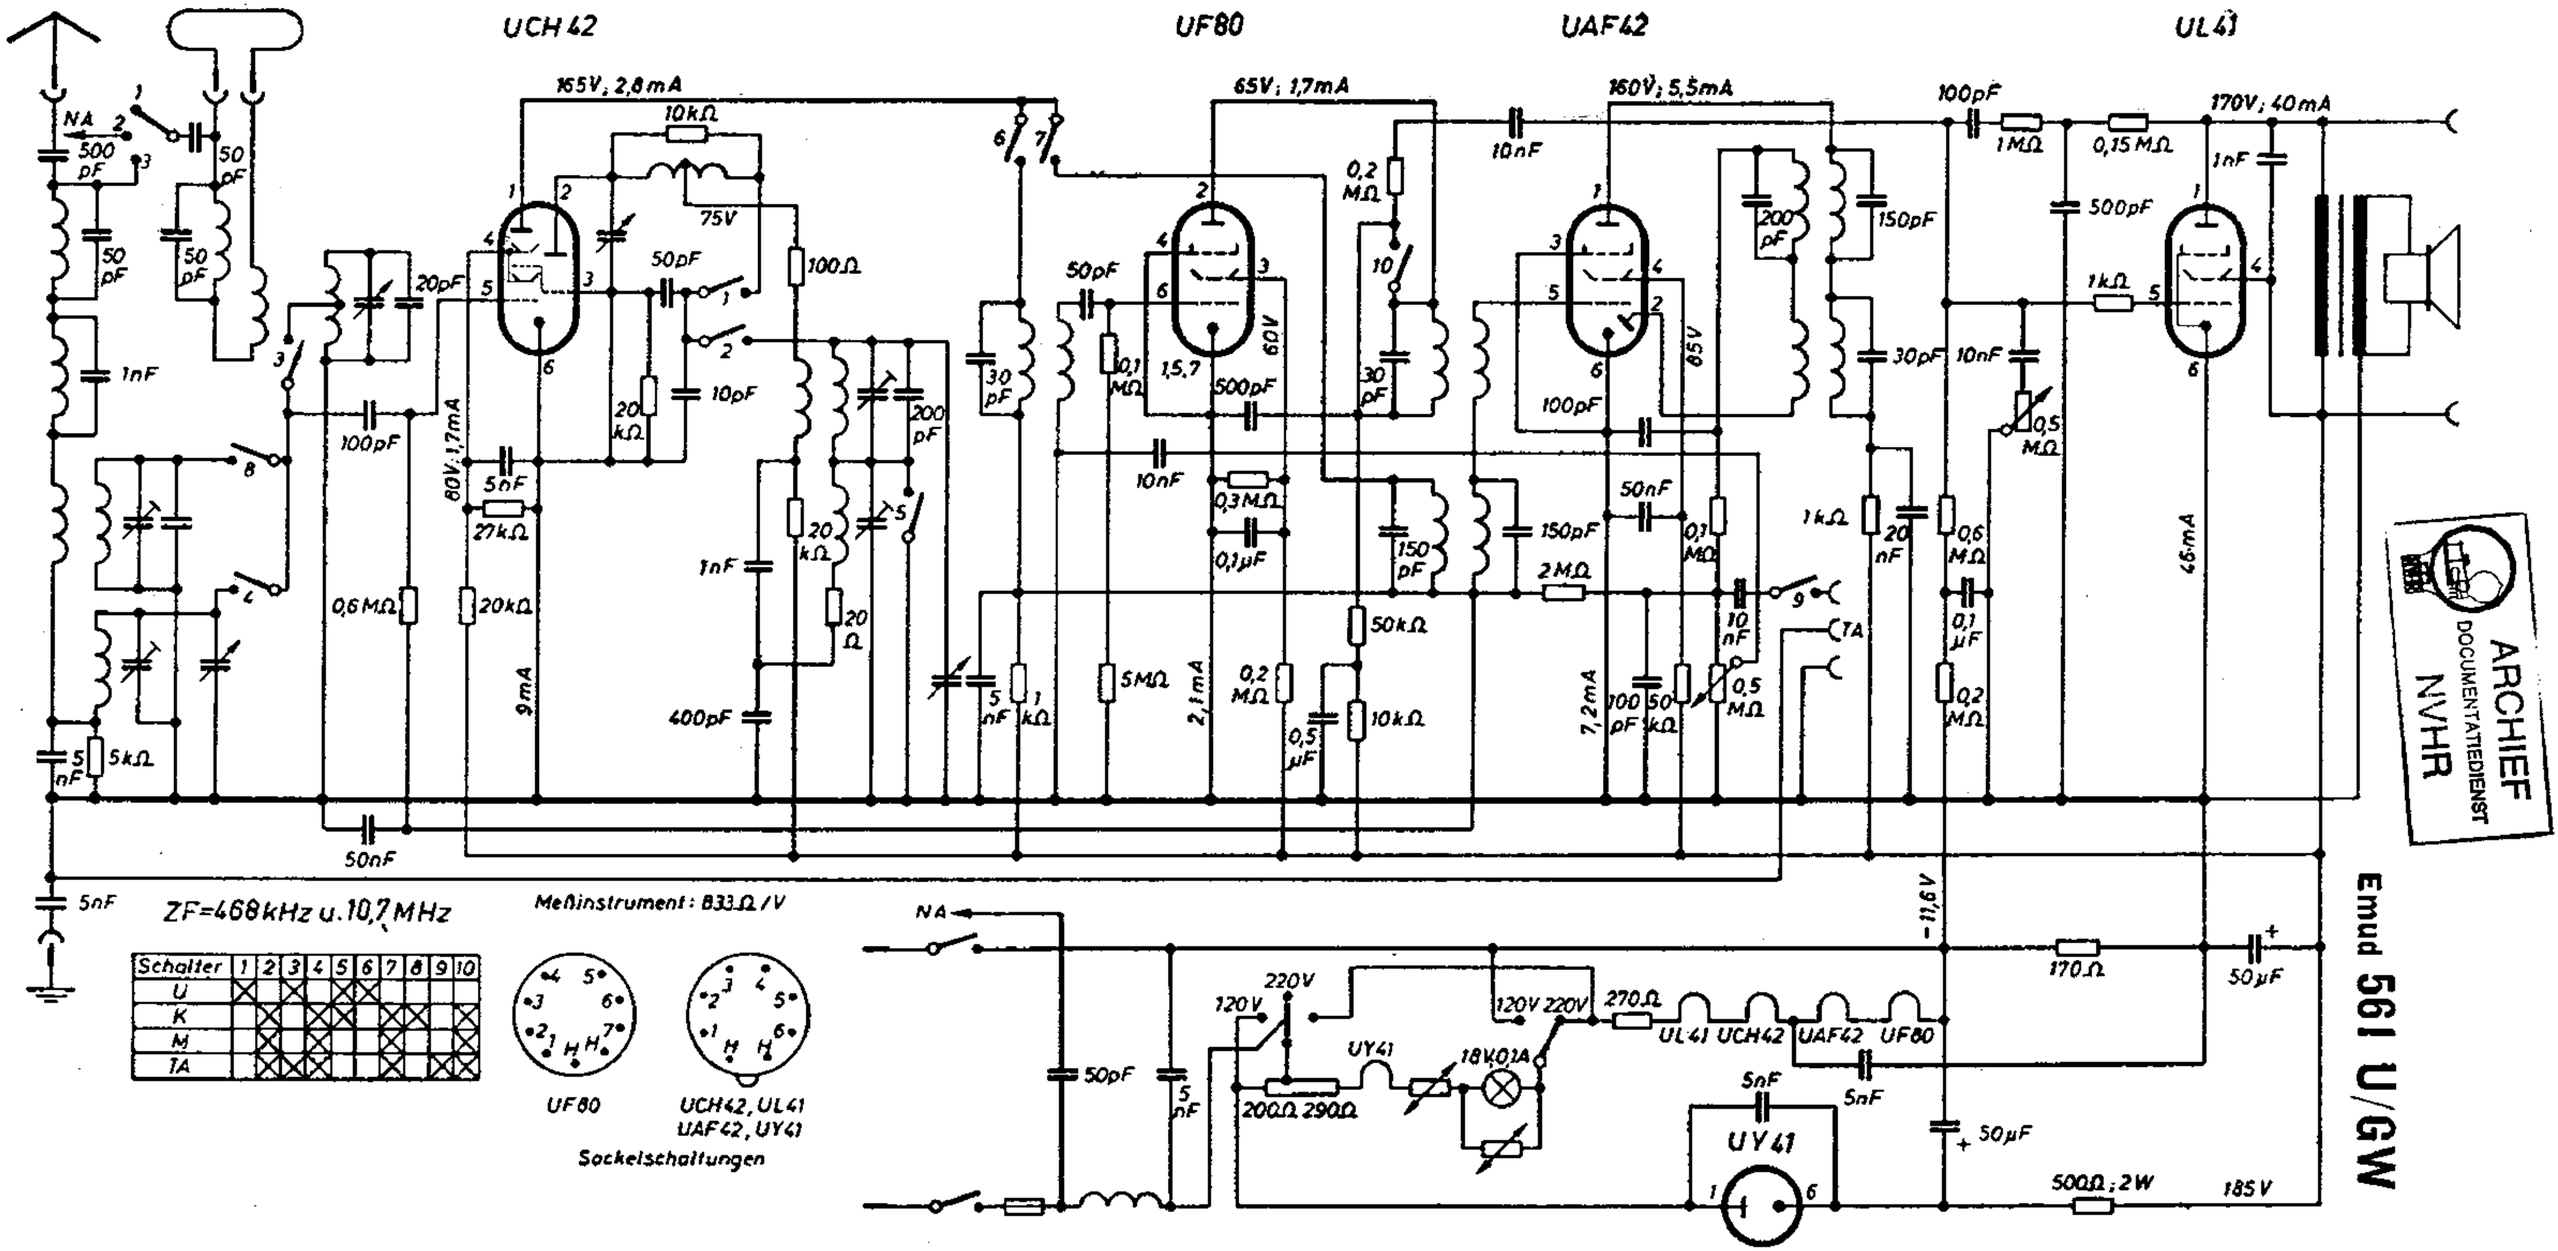
UCH42
UF80
UAF42
UL41
165V; 2,8mA
65V; 1,7mA
160V; 5,5mA
170V; 40mA
NA
500 pF
50 pF
50 pF
1nF
10kΩ
75V
50pF
100Ω
20pF
100pF
80V; 1,7mA
5nF
27kΩ
20kΩ
0,6MΩ
9mA
20 kΩ
10pF
1nF
400pF
200 pF
20 kΩ
20 Ω
50nF
5nF
5kΩ
30 pF
0,1 MΩ
1,5,7
60V
500pF
10nF
0,3MΩ
0,1μF
5MΩ
2,1mA
0,2 MΩ
0,5 μF
50kΩ
10kΩ
5 nF
1 kΩ
0,2 MΩ
10nF
10
30 pF
150 pF
2MΩ
65V
100pF
7,2mA
100 pF
50 kΩ
50nF
0,1 MΩ
10 nF
0,5 MΩ
9
TA
200 pF
150pF
30pF
1kΩ
20 nF
0,6 MΩ
0,1 μF
0,2 MΩ
100pF
1 MΩ
0,15 MΩ
500pF
1kΩ
1nF
10nF
0,5 MΩ
46mA
ZF=468kHz u.10,7MHz
Meßinstrument: 833Ω/V
Schalter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
U
K
M
TA
UF80
UCH42, UL41
UAF42, UY41
Sockelschaltungen
NA
50pF
5 nF
220V
120V
UY41
200Ω 290Ω
18V;0,1A
120V 220V
270Ω
UL41 UCH42 UAF42 UF80
5nF
5nF
UY41
-11,6V
170Ω
50μF
50μF
500Ω; 2W
185V
Emud 561 U/GW
ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR