

UL41

UABC80

UF41


UCH81

UC92


NA

Meßinstrument: 833Ω/V
(Klammerwerte bei UKW)

gezeichnete Schalterstellung: MW

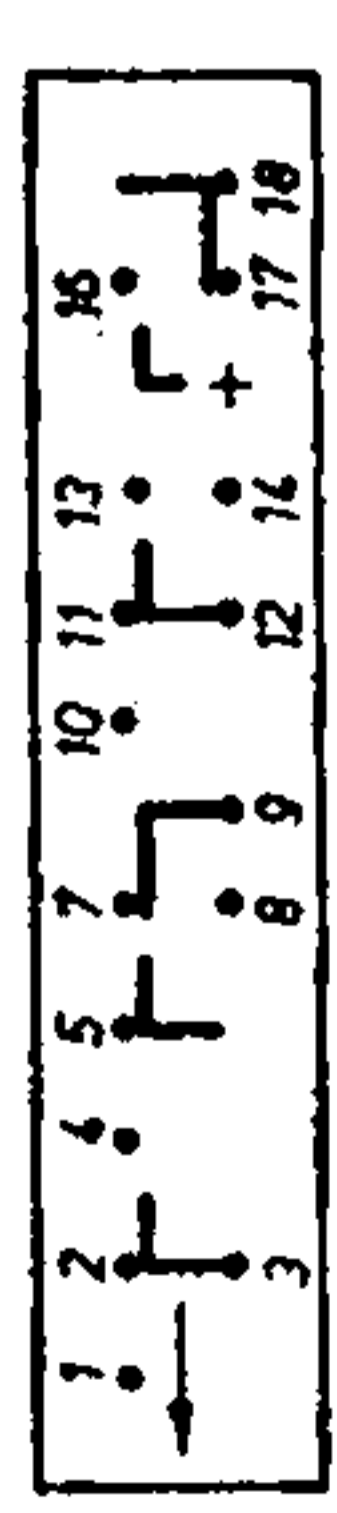

gezeichnete Schalterstellung UKW/MW

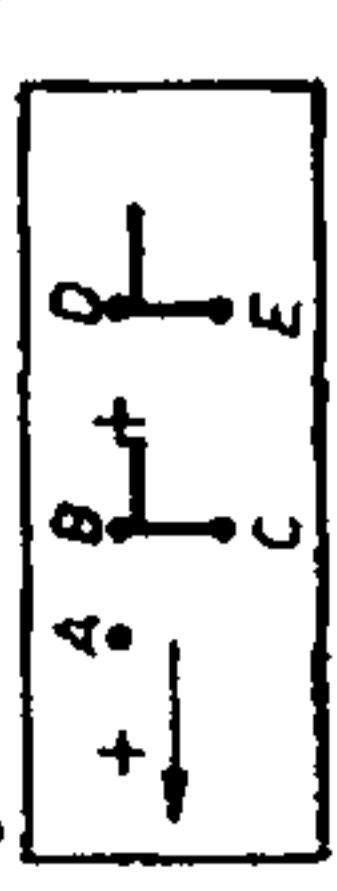

+ Stützpunkt



UF41, UL41



UCH81, UABC80



UC92

Socket connections

Grundig 1010 GW und 1012 GW