


Gleichspannungen mit GRUNDIG-Röhrenvoltmeter RV3 (Ri=30MΩ) gegen Masse gemessen (Betriebsart: „Horiz ext“; Mittlere Strahlage, Netzspannung 220V)  
 Oszillogramme im Zeitablenkteil gezeigt bei Betriebsart: „+int“, Niveau-Regler in Stellung „Autom“  
 Strahlverschiebungsregler in Mittelstellung.  
 DC-VOLTAGES MEASURED AGAINST CHASSIS WITH GRUNDIG V.T.V.M. RV3 (Ri=30MΩ) (MODE OF OPERATION: „HORIZ EXT“ BEAM CENTERED, LINE VOLTAGE 220V)  
 MODE OF OPERATION FOR WAVEFORMS DISPLAYED IN SWEEP GENERATOR: „+int“, NIVEAU-CONTROL SET TO „AUTOM“, BEAM-POSITION CONTROL IN CENTER-POSITION.

Änderungen vorbehalten!  
 ALTERATIONS RESERVED!

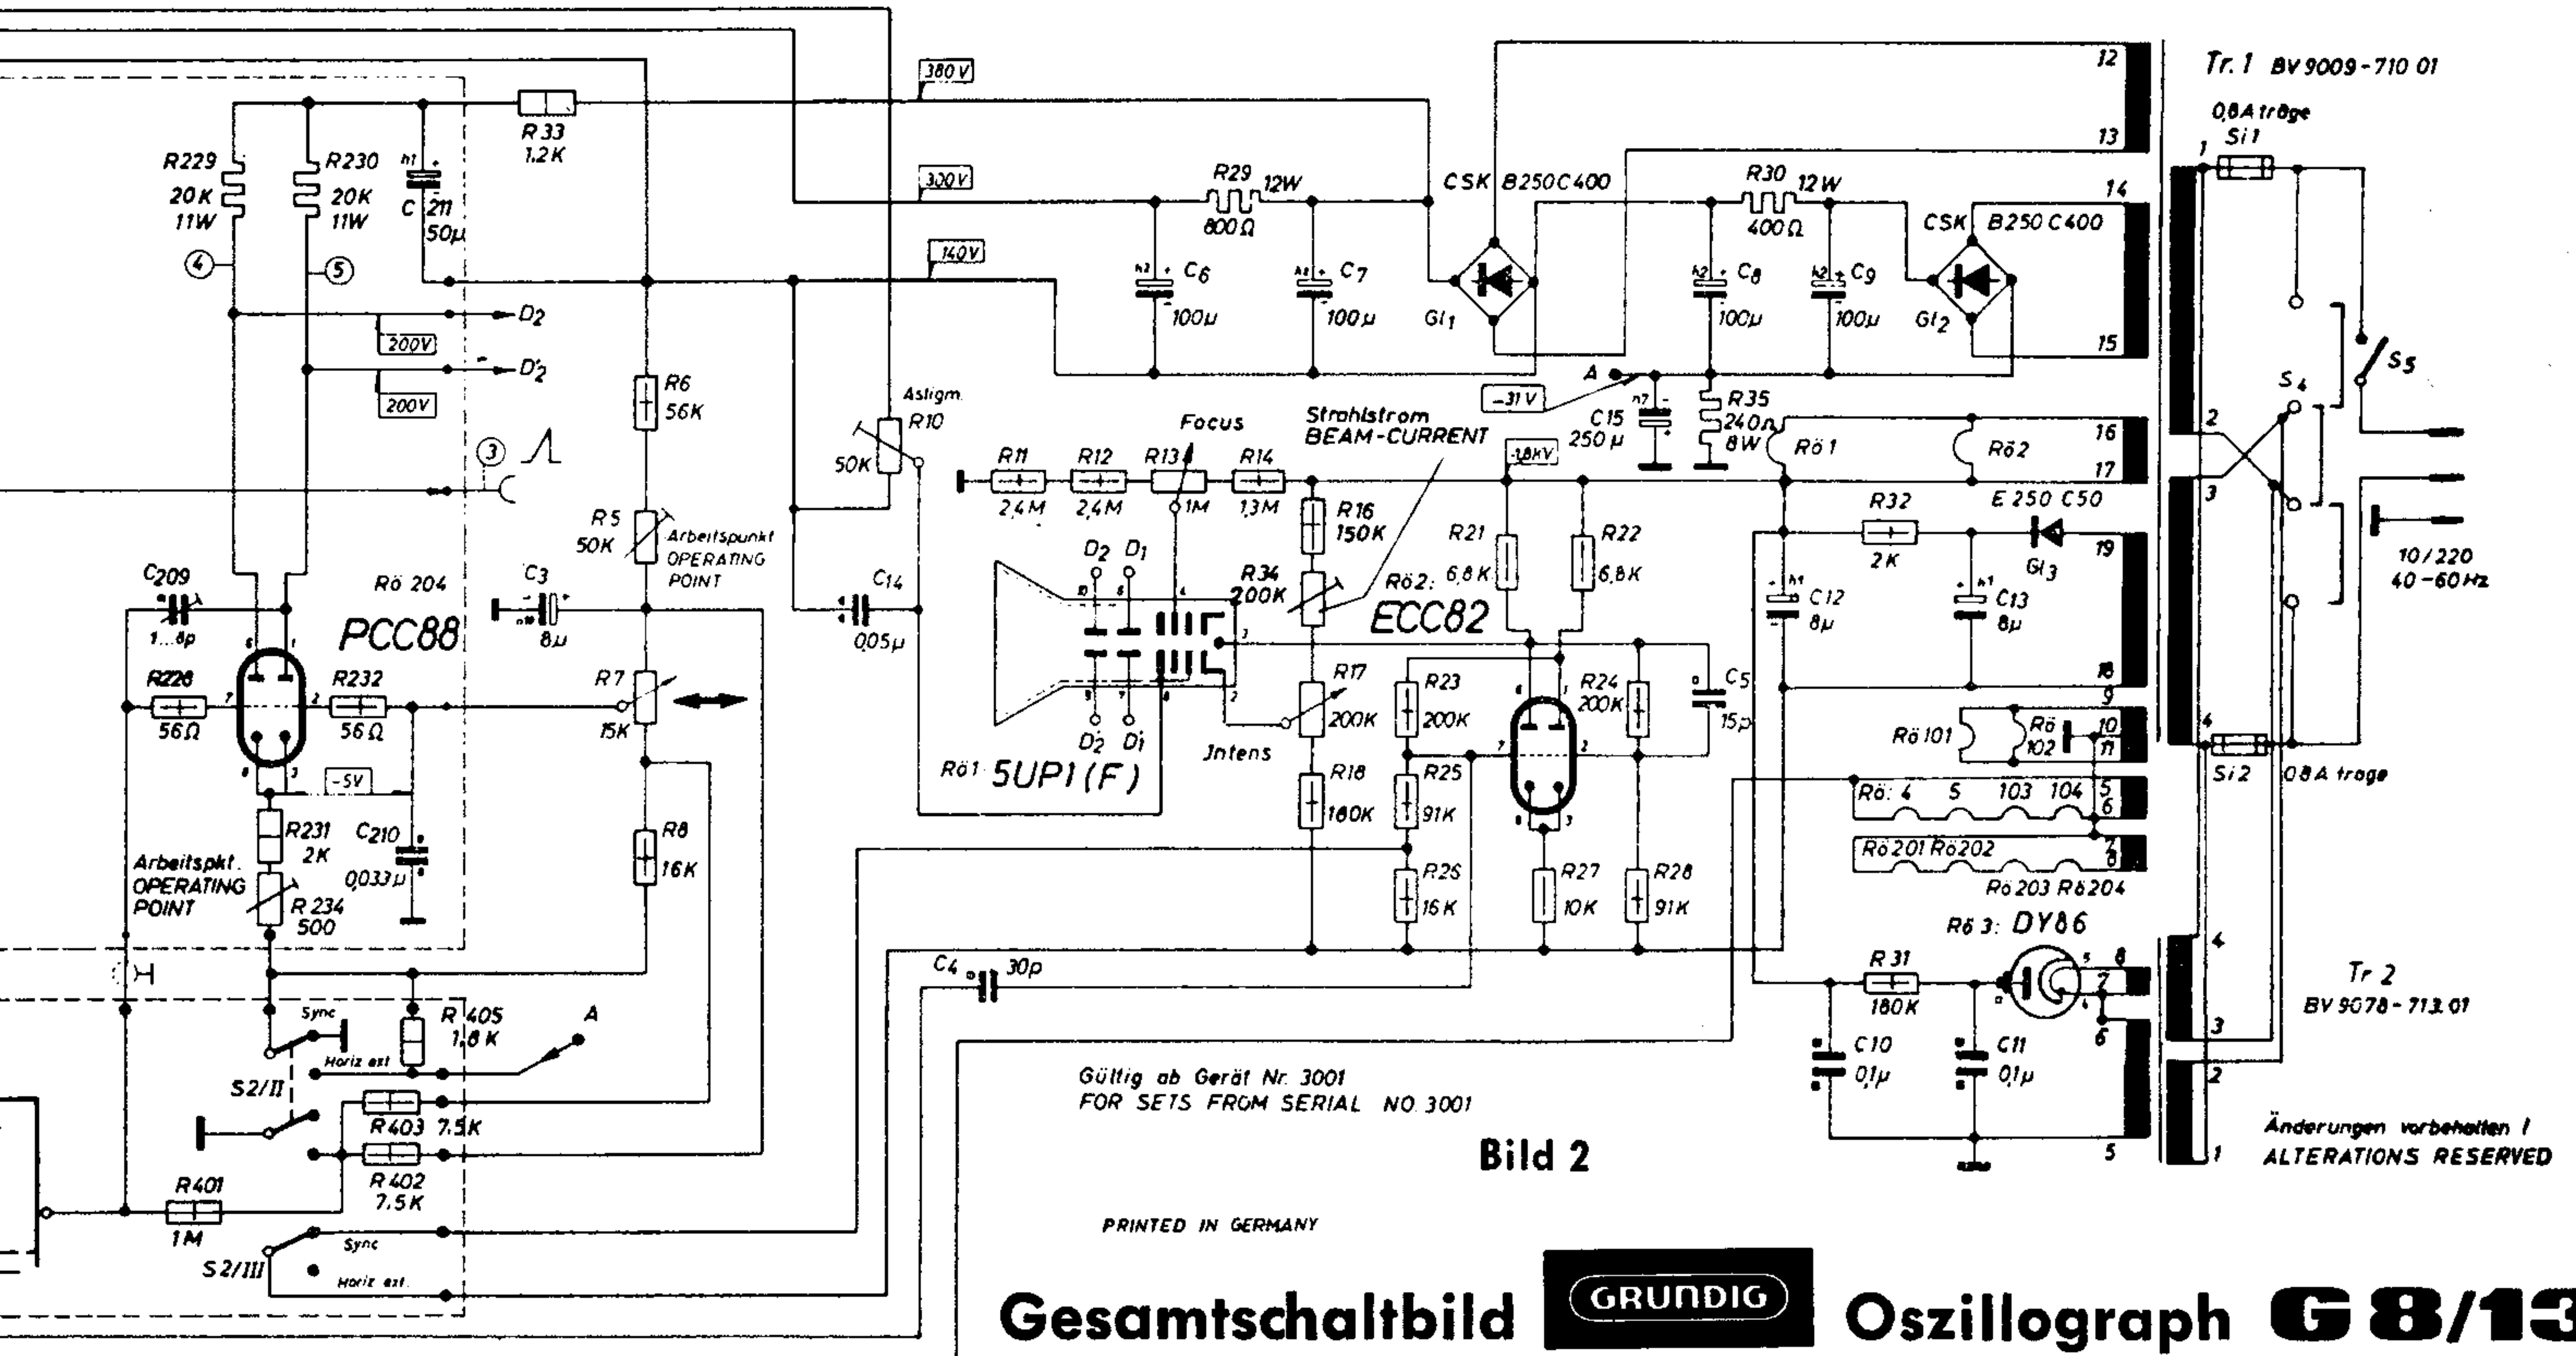

Änderungen vorbehalten!  
 ALTERATIONS RESERVED!

# Gesamtschaltbild **GRUNDIG** Oszillograph **G 8/13**